



PWM2001 光电式多参数模组 用户手册

版本: V1.0 日期: 2018/12/18



目录

1	概述		4
2	特点		4
3	应用范	围	5
4	电气料	}性	5
5	串口协	,议帧定义	7
	5.1	帧头	7
	5.2	数据包	
		5.2.1 数据头字节	8
		5.2.2 关键数据	8
6		7令定义	
	6.1	主机发送指令	
		6.1.1 启动一次血压测量命令	
		6.1.2 停止一次血压测量命令	
		6.1.3 设备 LED 开始闪烁指令	
		6.1.4 设备 LED 停止闪烁指令	
	6.2	从机返回数据格式	
		6.2.1 从机启动血压测试返回格式	
		6.2.2 从机波形数据返回格式	
		6.2.3 从机血压数据测试成功返回格式	
		6.2.4 从机血压数据测试错误返回格式	
_	## 	6.2.5 从机停止血压测试返回格式	
		├语与定义	
8		播	
		广播类型	
^		广播规则 效据通信	
9		私有通信	
	9.1	9.1.1 协议架构图	
		9.1.2 Layer 0—Hardware Layer	
		9.1.3 Layer 1—Profile Layer	
		9.1.4 Layer 2 —Transport Layer	
		9.1.5 Layer 3 — Application Layer	
		9.1.6 举例	
1	0 蓝牙:	功能命令定义	
_		命令列表	
		· 设置命令(0x03)	
		10.2.1 设置命令 Key ID 列表	
		10.2.2 时间设置 Key(0x01)	
		10.2.3 时间设置返回 Key (0x01)	
		10.2.4 设备闪烁设置 Key(0x06)	
		•	



10.2.5 设备闪烁设置返回 Key (0x06)	21
10.3 数据同步(0x05)	21
10.3.1 数据同步命令 Key ID 列表	21
10.3.2 同步未同步数据 Key (0x03)	22
10.3.3 同步未同步数据返回 Key (0x03)	22
10.3.4 同步当前波形数据 Key (0x09)	22
10.3.5 同步当前波形数据返回 Key (0x09)	23
10.3.6 数据同步发生错误 Key (0x0B)	23
10.4 控制命令(0x08)	23
10.4.1 控制命令 key ID 列表	23
10.4.2 设备启动一次测量 key(0x01)	24
10.4.3 设备启动一次测量返回 key(0x01)	24
10.4.4 设备停止当前测量 key(0x02)	25
10.4.5 设备停止当前测量返回 key(0x02)	25
10.5 握手命令(0xFF)	26
10.5.1 握手命令 Key ID 列表	26
10.5.2 握手命令请求 Key (0x01)	26
11 引脚分布图	27
11.1 引脚说明	27
12 功能框图	28
13 管脚尺寸	29
14 典型应用	30
15 回流焊焊接温度曲线	30




1 概述

PWM2001 模组是一款可以测量心率、呼吸率等多种人体参数的模块,可以通过有 线(UART)或无线(BLE4.0)连接的方式从模组读取测量数据。

模组可另提供移动端 SDK 开发包,当采用 BLE4.0 连接时,方便进行移动应用端软件的开发。

模组单面贴装元器件,边角采用邮票孔连接的方式,方便贴装。



2 特点

外形尺寸: 55mm X 35mm X 3.8mm

输入电压: DC5V(接 17 脚)或者 4.2V 锂电池 (接 20 脚)

输入电流: 500mA

可测量参数:心率、心律不齐、心律变异性、呼吸率、动脉硬化指数、焦虑指数、脉象、脉搏波传导速度,血压。

测量范围和精度:

血压(BP)范围:30~200mmHg,精度:在个体校准后,均差为±5mmHg

血压饱和度(SPO2):范围 85%~100%,精度:在正常供血情况下,误差为±2%(医疗级,可选配)

心率 (HR): 范围 30~250bpm, 精度: ± 2bpm@30~150bpm; ±

Nanochan

光电式多参数模组用户手册

3bpm@151~250bpm(医疗级)

脉象(PT):复合脉象(由滑脉、平脉、弦脉、数脉、迟脉、缓脉、促脉、结脉、止脉这 9 种脉象中的两种组合而成)

呼吸频率(RR):范围 6~60 次/分,精度正常呼吸状态下,误差为±2

脉搏波传导速度(): 范围 0.6~9.9m/S

动脉硬化指数(SIS):范围 1.0~9.9

焦虑指数(SNA):范围 0.1~9.9

心率变异性:支持短程心率变异性分析

模组通讯方式: 有线 UART; 无线蓝牙 BLE4.0。

充电功能: 模组自带充电管理接口,可外接可充电锂电池(建议电池容量至少500 mAh)。

3应用范围

家庭医疗管理、健康智能硬件、健康管理平台。

4 电气特性

环境要求		
工作环境温度	10°C ~ +40°C	
工作环境湿度	20% ~ 80%	
存储环境温度	0°C ~ +50°C	
存储环境湿度	10% ~ 80%	

串口波特率: 57600

串口设置: N81

流控: 无

数据格式:二进制



符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
VBAT	工作电压	_	3.7	4.2	5.5	V
ID D	工作电流	输出引脚无负载	_	_	130	m A
V IL	TX 引脚低电平输入电压		_	_	0.8	V
V JH	TX 引脚高电平输入电压	_	2.8	_	_	V
VOL	RX 引脚低电平输出电压	$ID \Gamma = LBD$	_	_	0.4	V
V O H	RX 引脚高电平输出电压	$IO \Gamma = LBD$	2.9	_	_	V
IO L	RX 口灌电流	_	8	TBD	TBD	m A
tS S T	系统启动时间	_	500	_	_	m S
RRVDD	VDD 上升速率	_	TBD	_	_	V/m s
BRPON	上电波特率	_	_	57600	_	Нz

BLE接收器特性

DLE按収益付注					
参数	条件	最小	典型	最大	单位
灵敏度@0.1% BER	_	_	-98	_	dBm
最大接收信号@0.1% BER	_	0	_	_	dBm
共信道C/I	_	_	10		dB
	F = F0 + 1 MHz		-5	_	dB
	F = F0 - 1 MHz		-5		dB
 邻道选择性C/I	F = F0 + 2 MHz		-25		dB
初旦选择任U/1	F = F0 - 2 MHz		-35		dB
	F = F0 + 3 MHz		-25		dB
	F = F0 - 3 MHz		-45		dB
	30 MHz - 2000 MHz	-10	_	_	dBm
拉类机阻塞粉丝	2000MHz - 2400MHz	-27	—	—	dBm
抗带外阻塞性能	2500MHz - 3000MHz	-27			dBm
	3000MHz - 12.5GHz	-10			dBm
互调性能	_	-36	_	_	dBm



BLE发射器特性

参数	条件	最小	典型	最大	单位
射频发射功率	_		7.5	10	dB m
射频功率控制范围	_	_	25	_	dB
	F = F0 + 1 M H z	_	-14.6	_	dB m
	F = F0 - 1 M H z	_	-12.7	_	dB m
	F = F0 + 2 M H z	_	-44.3	_	dB m
 邻道发射功率	F = F0 - 2 M H z	_	-38.7	_	dB m
(中国)(大利)(中)	F = F0 + 3 M H z	_	-29.2	_	dB m
	F = F0 - 3 M H z	_	-4 5	_	dB m
	F = FO +> 3 M H z	_	- 50	_	dB m
	$F = F0 \rightarrow 3 M H z$	_	- 50	_	dB m
Δflavg	_	_	_	265	kH z
Δf2max	_	247	_	_	dB m
Δf2avg/Δf1avg	_	_	-0.92	_	dB m
IC F T	_	_	-10	_	kH z
频率漂移率	_		0.7	_	kHz∕50 µs
频率漂移	—	_	2	_	kH z

5 串口协议帧定义

本协议中,如无特别说明,所有数值均表示十六进制格式。

协议帧的格式如下:

MSB LSB

帧头	数据包
8 bytes	0-512 bytes

5.1 帧头

MSB LSB

引导字	协议版本	长度(1)	命令字节	序列号(2)
1 bytes	1 bytes	2 bytes	2 bytes	2 bytes
0xFE	0x01	长度	命令号	序列号

注(1): 长度为整个协议帧的所有数据字节长度;

注(2): 序列号为发送的数据帧序号,从 0x0000 开始,每发新的一帧,编号加 1,发送和接

Nanochap

光电式多参数模组用户手册

收的数据帧分开编号。

5.2 数据包

数据包由不同类型的数据帧构成,有三种类型的数据帧,定义如下:

类型字节	长度字节	数据字节
0A	不定	由长度位决定
12	1 bytes	由长度位决定
18	不定	由长度位决定

主机与从机的通信数据,在类型为12的数据包中传输,该包中的数据字节定义如下:

MSB

数据头字节	关键数据
2 bytes	0-510 bytes

类型 0A 和 18 的数据桢可以发 0A 00 和 18 00,或者不发。

5.2.1 数据头字节

数据头字节由命令字和关键字构成:

MSB	LSB
命令字	关键字

命令字	关键字
1 bytes	1 bytes

不同的命令字有不同的定义,同一命令字下不同的关键字实现不同的功能,详见下节定义。

5.2.2 关键数据

详见下节定义。



6 串口命令定义

6.1 主机发送指令

6.1.1 启动一次血压测量命令

	帧内定义	值	说明
	引导值(1 Bytes)	FE	
帧	版本号(1 Bytes)	01	
 	长度(2 Bytes)	00 11	
	命令号(2 Bytes)	75 31	
	序列号(2 Bytes)	XX XX	当前帧的序号
	类型字节(1 Bytes)	0A	
	长度字节	00	
数	类型字节(1 Bytes)	12	
据	长度字节(1 Bytes)	03	
包	数据字节	08 01 01	启动血压测量
	类型字节(1 Bytes)	18	
	长度字节	00	

6.1.2 停止一次血压测量命令

	帧内定义	值	说明
	引导值(1 Bytes)	FE	
帧	版本号(1 Bytes)	01	
 	长度(2 Bytes)	00 10	
	命令号(2 Bytes)	75 31	
	序列号(2 Bytes)	XX XX	当前帧的序号
	类型字节(1 Bytes)	0A	
	长度字节	00	
数	类型字节(1 Bytes)	12	
据	长度字节(1 Bytes)	02	
包	数据字节	08 02	停止血压测量
	类型字节(1 Bytes)	18	
	长度字节	00	



6.1.3 设备 LED 开始闪烁指令

	帧内定义	值	说明
	引导值(1 Bytes)	FE	
 帧	版本号(1 Bytes)	01	
映	长度(2 Bytes)	00 11	
	命令号(2 Bytes)	75 31	
	序列号(2 Bytes)	XX XX	当前帧的序号
	类型字节(1 Bytes)	0A	
	长度字节	00	
数	类型字节(1 Bytes)	12	
据	长度字节(1 Bytes)	03	
包	数据字节	03 06 01	打开设备 LED 闪烁功能
	类型字节(1 Bytes)	18	
	长度字节	00	

6.1.4 设备 LED 停止闪烁指令

	帧内定义	值	说明
	引导值(1 Bytes)	FE	
帧	版本号(1 Bytes)	01	
 	长度(2 Bytes)	00 11	
	命令号(2 Bytes)	75 31	
	序列号(2 Bytes)	XX XX	当前帧的序号
	类型字节(1 Bytes)	0A	
	长度字节	00	
数	类型字节(1 Bytes)	12	
据	长度字节(1 Bytes)	03	
包	数据字节	03 06 00	关闭设备 LED 闪烁功能
	类型字节(1 Bytes)	18	
	长度字节	00	



6.2 从机返回数据格式

6.2.1 从机启动血压测试返回格式

主机发送开始测试指令后,设备会发送该数据帧进行应答。

	l	帧内定义	值	说明
	引导值(1 Bytes)		FE	
帧	版本号	를(1 Bytes)	01	
头	长度	(2 Bytes)	00 1E	
	命令号(2 Bytes)		27 12	
	序列号(2 Bytes)		XX XX	当前帧的序号
	类型字节(1 Bytes)		0A	
	长度字节		00	
数	类型字节(1 Bytes)		12	
据	长度字节(1 Bytes)		12	
包	数	数据内容1(2	08 01	
	据	Bytes)	00 01	
	字	数据内容 2 (16	00 00 00 00	
	节	Bytes)	00 00	

6.2.2 从机波形数据返回格式

	帧内定义		值	说明
	引导值(1 Bytes)		FE	
 帧	版本号(1 Bytes)		01	
 头	长度(2 Bytes)		00 2E	
	命令号(2 Bytes)		27 12	
	序列号(2 Bytes)		XX XX	当前帧的序号
	类型字节(1 Bytes)		0A	
	长度字节(1 Bytes)		00	
数	类型字节(1 Bytes)		12	
据	长度字节(1 Bytes)		22	
包	数	数据类型(2 Bytes)	05 09	表示该数据为波形数据
	据字	数据内容1(32 Bytes)	xx xx xx xx	详见举例
	节	,		

举例:



FE 01 00 2E 27 12 00 16 **0A** 00 **12** 22 05 09 71 00 70 40 6F 00 6E C0 6E C0 71 C0 71 00 74 00 95 00 BB 00 B6 40 97 00 82 00 78 40 70 40 6D 40 解释:

05 09 表示波形数据返回,后面为波形数据,波形数据用 16 进制表示,共 32 字节,每 2 个连续的字节(例如: 71 00)为一个波形数据,血压波形数据共 10bit,高 8bit 在前,低 8bit 在后,在低 8bit 中高 2bit 有效。

例如 70 40 这 2 个字节的数据,可以按照如下格式转换为波形数据: (0x70 << 2) + (0x40 >> 6)。

6.2.3 从机血压数据测试成功返回格式

	帧内定义		值	说明
	引导值(1 Bytes)		FE	
#F:	版本	号(1 Bytes)	01	
帧	长度	(2 Bytes)	00 2E	
头	命令	号(2 Bytes)	27 12	
	序列	号(2 Bytes)	xx xx	当前帧的序号
	类型	字节(1 Bytes)	0A	
	长度	字节(1 Bytes)	00	
	类型	字节(1 Bytes)	12	
	长度	字节(1 Bytes)	22	
		数据类型(2 Bytes)	05 03	表示该数据为测试结果
		数据内容 1(12 Bytes)	xx xx ······ xx xx	
		数据内容 2(1 Bytes)	XX	动脉硬化指数 (需除以 10 取小数)
		数据内容 3(1 Bytes)	XX	焦虑指数 (需除以 10 取小数)
		数据内容 4(1 Bytes)	XX	脉搏波速度(需除以10取小数)
数		数据内容 5(1 Bytes)	XX	
据	数 据	数据内容 6(1 Bytes)	XX	
包		数据内容 7(1 Bytes)	XX	hrv
	字	数据内容 8(5 Bytes)	xx xx ······ xx xx	
	节	数据内容 9(1 Bytes)	XX	呼吸率
		数据内容 10(1 Bytes)	XX	高压
		数据内容 11(1 Bytes)	XX	低压
		数据内容 12(1 Bytes)	XX	心率数据
		数据内容 13(1 Bytes)	XX	脉象
		数据内容 14(1 Bytes)	XX	犀血
		数据内容 15(3 Bytes)	XX XX	

举例:

FE 01 00 2E 27 12 00 80 0A 00 12 22 05 03 00 42 00 79 00 00 00 00 00 00 00

12

19 26

Nanochap

光电式多参数模组用户手册

<mark>59</mark> 00 00 25 02 00 00 00 00 <mark>0E A6 68 46 61 63</mark> 00 00 00 解释:

关键数据长度为 34 个字节,05 03 表示测试结果,其后为测试结果数据,测试结果数据 用 16 进制表示,共 32 字节,其中 19 26 59 为动脉硬化指数、焦虑指数、脉搏波速度(均需除以 10 取小数);25 为 HRV(心率变异性);0E A6 68 46 61 63 为呼吸率、高压值、低压值、心率、脉象、血氧, 其余位置数据为保留值(具体数值可能有变化)。

关于脉象的解析如下脉象字节各位组合:如脉象字节为 0x23,则脉象为滑缓脉象。

Bit3-0:=0 无脉象=1 平脉=2 弦脉=3 滑脉 Bit7-4: =1 迟脉=2 缓脉=3 数脉=4 结脉 =5 止脉=6 促脉

6.2.4 从机血压数据测试错误返回格式

	帧内定义		值	说明
	引导值(1 Bytes)		FE	
帧	版本号	(1 Bytes)	01	
头	长度(2 Bytes)		00 1E	
	命令号(2 Bytes)		27 12	
	序列号(2 Bytes)		XX XX	当前帧的序号
	类型字	Z节(1 Bytes)	0A	
	长度字	2节	00	
数	•		12	
据			12	
包	数据	数据类型(2 Bytes)	05 0B	表示数据测试错误
	製店 字节	数据内容 1(1 Bytes)	01	代表血压数据
	1 11	数据内容 2(15 Bytes)	00 00 00 00	保留

举例:

解释:

如果因为手指压力太大等原因造成测量结果生成错误,从机会返回该数据测试错误帧。 其中 05 0B 代表数据测试错误,01 代表血压数据,05 0B 01 合在一起代表血压数据测试错误。

6.2.5 从机停止血压测试返回格式

主机发送停止测试指令后,设备会发送该数据帧进行应答。



	帧内定义		值	说明
	引导值(1 Bytes)		FE	
 帧	版本与	号(1 Bytes)	01	
映	长度	(2 Bytes)	00 1E	
	命令号(2 Bytes)		27 12	
	序列号(2 Bytes)		XX XX	当前帧的序号
	类型字节(1 Bytes)		0A	
	长度字节		00	
数	类型字节(1 Bytes)		12	
据	长度字节(1 Bytes)		12	
包	数	数据内容1(2	08 02	
	据	Bytes)	08 02	
	字	数据内容 2 (16	00 00 00 00	
	节	Bytes)	00 00	

7 蓝牙术语与定义

APP: 指安装在手机上的应用程序。

设备: 指智能血压计产品。

主机:本文中指安装有APP的手机。

从机:本文中指使用低功耗蓝牙技术的设备。

8 蓝牙广播

8.1 广播类型

按照协议,本设计选取广播类型为非定向可连接广播,即 ADV_IND。

8.2 广播规则

广播规则定义如下:

- 1、从机正常广播时间间隔设置为1.25s。
- 2、从机充电状态广播时间间隔设置为 62.5ms。
- 3、蓝牙服务

在设计中使用自定义以下属性:



Attribute Handle	UUID	Attribute Type	Attribute Value
0x000C	0xFEE7	Primary Service	wechat Service

9 蓝牙数据通信

主机和从机处于连接状态时, 双方进入数据通信模式。

9.1 私有通信协议架构

9.1.1 协议架构图

数据通信协议分为四层,如下所示:

Layer 3	Application Layer
Layer 2	Transport Layer
Layer 1	Profile Layer
Layer 0	Hardware Layer

9.1.2 Layer 0—Hardware Layer

9.1.2.1 Layer 0 描述

Layer 0 为蓝牙核心规范 4.0 内定义的蓝牙协议栈,主要是逻辑链路层控制和适配协议 (L2CAP) 和通用属性配置文件 (GATT)。

根据蓝牙规范,在 L2CAP 层上传输的 Data PDU Payload 有两种: LL Control PDU 和 LL Data PDU,由 Data PDU Header 内的 LLID 字段确定:

LLID	Definition	
00b	保留	
01b	LL Data PDU 逻辑链路层数据 PDU,表示	
010	L2CAP 报文延续,或者是一个空的 PDU	
10b	LL Data PDU 逻辑链路层数据 PDU,表示	



	L2CAP 报文开始,或者是一个完整的报文	
116	LL Control PDU 逻辑链路层控制 PDU,用于	
11b	管理连接	

GATT 协议栈基于 L2CAP 层的 LL Data PDU。

9.1.3 Layer 1—Profile Layer

在蓝牙协议栈中,layer1 由微信定义的 UART Profile 实现,ServiceUUID 为 0xFEE7(该 uuid 经蓝牙官方授权)。蓝牙设备需要暴露 3 个特征值(Characteristics): Write 特征值, Read 特征值, Indication 特征值。

蓝牙设备从 Write 特征值接受数据,从 Indication 特征值发送数据。Read 特征值内容 为 6 字节的 MAC 地址,当 ios 上的其他 app 连接上设备时,设备不会再广播,微信会读取该特征值,以确定是否要连接该设备

write interface 和 receive interface 的 MTU 为 20 字节。

9.1.4 Layer 2 —Transport Layer

9.1.4.1 Layer 2 功能描述

Layer 2 为 Transport 层,在 Layer 1 层上实现数据的传输。

数据传输以大端(MSB)在前(高字节在前)。

9.1.4.2 Layer 2 数据包结构

Layer 2 Packet 由 Header 和 Payload 组成,定义如下:

MSB LSB

Layer 2 Header	Layer 2 Payload
8 bytes	0-512 bytes

Layer 2 Header 部分定义:



MSB LSB

Preamble	Version	Length	Cmd Id	Sequence ID
1 bytes	1 bytes	2 bytes	2 bytes	2 bytes
0xFE	0x01	长度	命令号	序列号

Preamble:数据头引导字段,固定为0xFE。 Version:本协议层的版本号,初始为0x01。

Length: Layer 2 Header 及数据载荷部分的字节总长度。

Cmd Id: 命令号

Sequence ID: 数据包的序列号,从 0x0001 开始表示发送方发送的第一包数据,以后每发送一次数据,递增一次。设备端发送的 Sequence ID 永不为 0,手机端发送回应的 Sequence ID 和设备端发送的相同。手机端主动发送的 push 命令 Sequence ID 永远为 0。数据包采用 Protoalbuf 打包。

9.1.5 Layer 3 — Application Layer

9.1.5.1 Layer 3 数据包结构

Layer 3 Packet 基于 Layer 2 Payload,主体由 protobuf 协议构成。 每个 Protobuf 包由如下 3 个部分组成:

类型字节	长度字节	数据字节
1 bytes	不定	由长度位决定

如果 protobuf 的长度字节为 0,数据字节不存在。

Layer 3 Packet 共有 3 个 protobuf 包分别为:

类型字节	长度字节	数据字节
0A	不定	由长度位决定
12	1 bytes	由长度位决定
18	不定	由长度位决定

主机与从机的通信数据,在类型为 12 的 protobuf 包中传输,该包中的数据字节定义如下:

Header Payload (Key Value)



2 bytes	0-510 bytes
---------	-------------

其中 Header 定义:

MSB LSB

Command ID	Key ID
1 bytes	1 bytes

Command ID: 命令字。

Key ID: 关键字

不同的 Command ID 有不同的 Payload 定义,详见下一节描述。

相同 Command ID 下拥有不同的 Key ID 以实现不同的功能,详见下一节描述。

9.1.6 举例

一包完整数据帧的内容为: FE 01 00 11 75 31 00 00 0A 00 12 03 08 01 01 18 00。 其中: FE 01 00 11 75 31 00 00 为 Layer 2 Header,解析如下:

Layer 2 Header

Preamble	Version	Length	Cmd Id	Sequence ID
1 bytes	1 bytes	2 bytes	2 bytes	2 bytes
0xFE	0x01	00 11 即 17	75 31 即 30001	00 00 即 0

OA 00 12 03 08 01 01 18 00 为 Layer 3 Packet,由 3 个 protobuf 包组成,解析如下:

类型字节	长度字节	数据字节
0A	00	无
12	03	08 01 01
18	00	无

类型 12 的 protobuf 包中的数据字节 08 01 01 解析如下:

Header		Payload (Key Value)
2 bytes		1 bytes
08	01	01



10 蓝牙功能命令定义

10.1 命令列表

Command ID	定义
0x03	设置命令
0x05	数据同步命令
0x08	控制命令
0xFF	握手命令

10.2 设置命令 (0x03)

10.2.1 设置命令 Key ID 列表

Key ID	定义
0x01	时间设置
0x01	时间设置返回
0x06	设备闪烁设置
0x06	设备闪烁设置返回

10.2.2 时间设置 Key(0x01)

10.2.2.1 功能描述

手机端通过这个命令把手机上的时间同步到设备上,使设备上的时间和手机端保持同步。

10.2.2.2 Key Value 内容

Key Value (8 bytes)						
Year	Month	Day	Hour	Minute	Second	Reserve



6 bits	4 bits	5 bits	5 bits	6 bits	6 bits	32 bits
有效值 0-63,	有效值	有效	有效	有效值	有效值	保留
从 2000 年开始, 15 表	1-12	值	值	0-59	0-59	
示 2015 年		1-31	0-23			

10.2.3 时间设置返回 Key (0x01)

10.2.3.1 功能描述

设备端通过这个 Key 返回时间同步的结果。

10.2.3.2 Key Value 内容

MSB LSB

Key Value (8 bytes)		
Return Key Reserve		
1 byte	7 bytes	

Return Key	定义
0x00	时间同步设置成功
0x01	时间同步设置失败

10.2.4 设备闪烁设置 Key(0x06)

10.2.4.1 功能描述

手机端通过这个命令设置设备点亮 LED 灯。该命令用来在大客户场景下找到具体的设备,不拘泥于点亮 LED 灯,但需要让工作人员识别出与主站建立连接的设备。

10.2.4.2 Key Value 内容



Key Value (8 bytes)		
Key Reserve		
1 byte	0 bytes	

Кеу	定义
0x00	设备闪烁停止
0x01	设置闪烁开始

10.2.5 设备闪烁设置返回 Key (0x06)

10.2.5.1 功能描述

设备端通过这个 Key 返回闪烁设置的结果。

10.2.5.2 Key Value 内容

MSB LSB

Key Value (8 bytes)		
Return Key Reserve		
1 byte	0 bytes	

Return Key	定义
0x00	设备闪烁设置成功
0x01	设置闪烁设置失败

10.3 数据同步(0x05)

10.3.1 数据同步命令 Key ID 列表

Key ID	定义
0x03	同步未同步数据
0x03	同步未同步数据返回



0x09	同步当前血压波形数据		
0x09	同步当前血压波形数据返回		
0x0B	数据同步发生错误 需要停止		

10.3.2 同步未同步数据 Key (0x03)

10.3.2.1 功能描述

手机端通过这个 Key 向设备请求所有存储的未同步数据。

10.3.2.2 Key Value 内容

无。

10.3.3 同步未同步数据返回 Key (0x03)

10.3.3.1 功能描述

设备端通过这个 Key 向手机发送所有存储的未同步数据。

10.3.3.2 Key Value 内容

数据解析见 6.2.3 章节。

10.3.4 同步当前波形数据 Key (0x09)

10.3.4.1 功能描述

手机端通过这个 Key 读取设备当前的波形数据。

10.3.4.2 Key Value 内容

无。



10.3.5 同步当前波形数据返回 Key (0x09)

10.3.5.1 功能描述

设备端通过这个 key 向手机端发送当前波形数据。

10.3.5.2 Key Value 内容

波形数据数据解析见 6.2.2 章节。

10.3.6 数据同步发生错误 Key (0x0B)

10.3.6.1 功能描述

设备端通过这个 key 向通知主机数据测试错误。

10.3.6.2 Key Value 内容

无。

10.4 控制命令 (0x08)

该命令实现主机对设备的控制或设备对主机的控制功能。

10.4.1 控制命令 key ID 列表

Key ID	定义
0x01	设备启动一次测量
0x01	设备启动一次测量返回
0x02	设备停止当前测量
0x02	设备停止当前测量返回



10.4.2 设备启动一次测量 key (0x01)

10.4.2.1 功能描述

主机通过该命令控制设备启动一次测量。

10.4.2.2 Key Value 内容

Return Key	定义
0x01	启动血压测试
0x02	启动 ECG 测试
0x03	启动血氧测试 (预留)

10.4.3 设备启动一次测量返回 key (0x01)

10.4.3.1 功能描述

设备通过该命令返回是否成功启动测量。

10.4.3.2 Key Value 内容

Key Value (8 bytes)		
Return Key	Reserve	
1 byte	0 bytes	

Return Key	定义
0x00	启动测量成功
0x01	电池电量不足



10.4.4 设备停止当前测量 key (0x02)

10.4.4.1 功能描述

主机通过该命令控制设备停止当前测量。

10.4.4.2 Key Value 内容

Return Key	定义
0x01	血压测试停止
0x02	ECG 测试停止
0x03	血氧测试停止(预留)

10.4.5 设备停止当前测量返回 key (0x02)

10.4.5.1 功能描述

设备通过该命令返回是否成功停止测量。

10.4.5.2 Key Value 内容

Return Key	定义
0x01	血压测试停止
0x02	ECG 测试停止
0x03	血氧测试停止(预留)



10.5 握手命令 (0xFF)

10.5.1 握手命令 Key ID 列表

Key ID	定义
0x01	握手命令请求
0x01	握手请求返回

10.5.2 握手命令请求 Key (0x01)

10.5.2.1 功能描述


手机端通过这个 Key 向设备发送握手信息。此命令 Key 在连接上设备后必须首先发送。

10.5.2.2 Key Value 内容

当前时间信息,同时间设置 key value。



11 引脚分布图

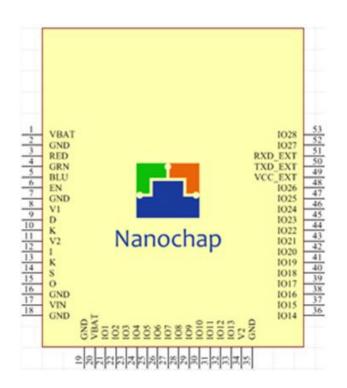


11.1 引脚说明

管脚序号	信号名称	信号类型	备注
1	VBAT	IN	外接电池接口(与管脚 20 内部连通),可外接
			可充电 4.2V 锂电池,充电电流 194mA,充满
			关断电流 8mA
2,7,16,18,19,35	GND	IN	模组接地引脚
3	RED	OUT	指示灯接口 (红灯)
4	GRN	OUT	指示灯接口 (绿灯)
5	BLU	OUT	指示灯接口 (蓝灯)
6	EN	IN	模组使能,默认高电平,接低电平时关断模
			组
8	V1	OUT	模组内部电源输出 1, 3.3V, 最大 200mA
9	D	1/0	调试接口,请悬空
10	К	1/0	调试接口,请悬空
11,34	V2	OUT	模组内部电源输出 2, 3.3V, 最大 100mA
12	ı	1/0	调试接口,请悬空
13	K	1/0	调试接口,请悬空
14	S	I/O	调试接口,请悬空




15	0	1/0	调试接口,请悬空
17	VIN2	IN	模组供电输入接口(+5V)
20	VBAT	IN	外接电池接口(与管脚1内部连通)
21~33,36~48,52,53	IOs	1/0	数字 IO 口,可定制功能,不用请悬空
49	VCC_EXT	IN	外部 UART 电平输入
50	TXD	IN	UART 接口,接外部的 TXT
51	RXD	OUT	UART 接口,接外部的 RXD

12 功能框图

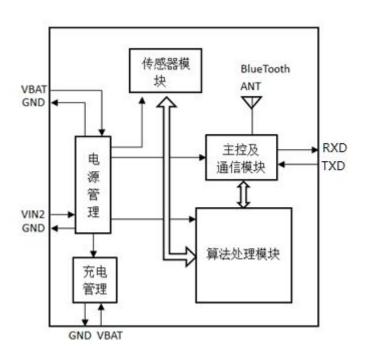




13 管脚尺寸

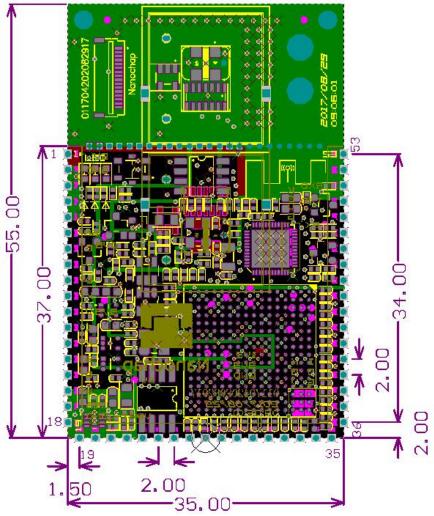

具体尺寸如上图所示,单位均为毫米,模组左边有 18 个邮票孔连接,下方有 17 个邮票 孔连接,右边有 18 个邮票孔连接。



14 典型应用

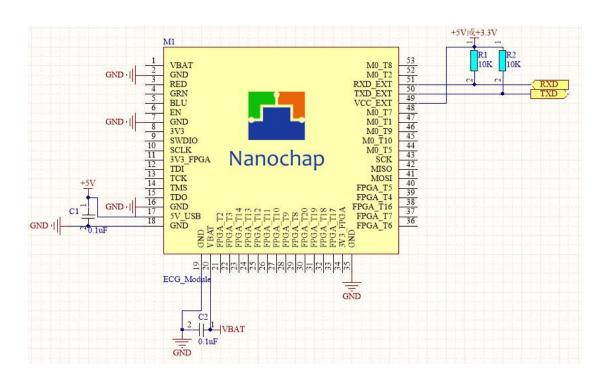

15 回流焊焊接温度曲线

回流焊温度曲线

项目	值
升温速率Ts 最大值到TL	最大值3℃/秒
预热	
最小温度值(TsMin.)	150 °C
典型温度值 (TsTyp.)	175℃
最大温度值 (TsMax.)	200 °C
时间(Ts)	60~180 秒
升温速率(TL 到TP)	最大值3℃/秒
持续时间:温度(TL)/时间(TL)	217℃/60~150 秒
温度峰值(TP)	最高温度260℃,持续10秒
目标温度峰值(TP 目标值)	260°C +0/-5°C
实际温度峰值(₽)5℃ 持续时间	20~40秒
降温速率TS 最大值到TL	最大值6℃/秒
从25℃ 调至温度峰值所需时间(t)	最长8 分钟



Copyright 2018 by Hangzhou Nanochap Electronics Co.,Ltd.

使用指南中所出现的信息在出版当时相信是正确的,然而暖芯迦对于说明书的使用不负任何责任。文中提到的应用目的仅仅是用来做说明,暖芯迦不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的,也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。暖芯迦产品不授权使用于救生、维生从机或系统中做为关键从机。暖芯迦拥有不事先通知而修改产品的权利,对于最新的信息,请参考我们的网址.http://www.nanochap.cn或与我们直接联系。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Emulators/Simulators category:

Click to view products by Nanochap manufacturer:

Other Similar products are found below:

AC244062 AC244064 SPC563M64CAL144 SPC563M64CAL176 ST7MDT2-EMU2B IM3316 IM1281B IM1275 IM1227 IM1259G IM1253B IM1253B(D) MJYS-QKJL-40/380V MJYS-QKJL-75/380V MJYD-JL-75/380V MJYD-JL-40/380V CI-B02CS01S CI-B03CS01S CI-B03GS01S GD10PJX120L2S HEDS-9730#Q50 HEDS-9700#F50 L-MZ07 L-MZ02 L-MZ021 TXVT4G6M-S JL_MOD_FH_V1.0 MKSDSOCKET-Pinboard V1 CY3250-24X33 AC244060 7027-D-350 DS1747WP-120IND+ AC244061 S5U1C31W74T1300 S5U1C17M13T1100 J-Link ULTRA+ AFM201TI-AY2LED2 AFW121T-EVB CP2102 CE118M12 ESP32-A1S ESP32-CAM ESP-32S ADZS-ICE-1000 ADZS-ICE-2000 USB-EA-CONVZ BH-USB-100v2-ARM BH-USB-100v2D BH-USB-200